


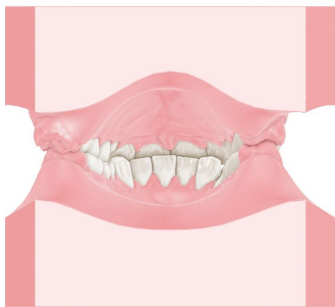
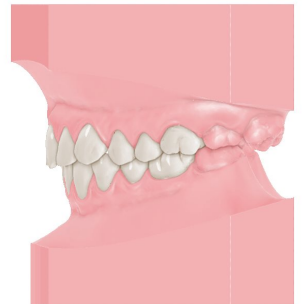
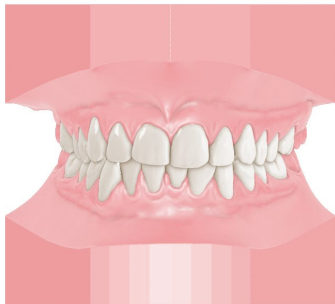




Rapporto di analisi del progetto

DIMOSTRATIVO 2023-02-07 DIMOSTRATIVO



Misure: Arcata superiore

#	Mesiale Distale
18	
17	
16	10.31 mm
15	6.19 mm
14	6.48 mm
13	6.46 mm
12	6.13 mm
11	8.01 mm
21	8.08 mm
22	5.58 mm
23	6.70 mm
24	5.94 mm
25	5.83 mm
26	10.13 mm
27	
28	

Analisi di Bolton

Rapporto complessivo	94.15%
Rapporto anteriore	81.09%

Lunghezza

Arcata superiore	0.00 mm
------------------	---------

Misure: Arcata inferiore

#	Mesiale Distale
48	
47	
46	10.96 mm
45	6.55 mm
44	6.38 mm
43	5.85 mm
42	5.35 mm
41	5.32 mm
31	5.43 mm
32	5.68 mm
33	5.58 mm
34	5.69 mm
35	6.54 mm
36	11.47 mm
37	
38	

Analisi di Bolton

Rapporto complessivo	94.15%
Rapporto anteriore	81.09%

Lunghezza

Arcata inferiore	0.00 mm
------------------	---------

#	Ti	R	To	B L	E I	M D
18	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
17	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
16	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
15	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
14	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
13	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
12	0.37 °	0.00 °	1.19 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
11	0.38 °	-1.81 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
21	0.11 °	-4.83 °	4.05 °	-0.69 mm	-0.02 mm	0.04 mm
22	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
23	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
24	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
25	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
26	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
27	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
28	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm

Ti	TIP
R	Rotazione
To	Torque
B L	Buccale Linguale
E I	Estrusione Intrusione
M D	Mesiale Distale

Mascherina Trasparente 1 - 5







Panoramica del Setup: Arcata superiore

Situazione Iniziale | Situazione Finale

#	Ti (Inizio)	Ti (Fine)	To (Inizio)	To (Fine)
18	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
17	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
16	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
15	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
14	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
13	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
12	0.00 °	0.37 °	0.00 °	1.19 °
11	0.00 °	0.38 °	0.00 °	0.00 °
21	0.00 °	0.11 °	0.00 °	4.05 °
22	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
23	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
24	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
25	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
26	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
27	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
28	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °

Ti	TIP
To	Torque

Mascherina Trasparente 1 - 5



TIP	1.00 °
Rotazione	2.00 °
Torque	1.00 °
Buccale Linguale	0.25 mm
Estrusione Intrusione	0.10 mm
Mesiale Distale	0.25 mm
Distanza	0.05 mm
Numero di modelli desiderati	5
Template	SI
Ritarda stage per gli attachi	Nessun ritardo
Settimanale per allineatore	2 Settimanale
Tempo necessario	2 mesi, 2 Settimanale


Durata del trattamento 2 mesi, 2 Settimanale



#	Ti	R	To	B L	E I	M D
48	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
47	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
46	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
45	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
44	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
43	0.00 °	21.41 °	0.18 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
42	2.66 °	10.12 °	7.31 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
41	1.01 °	0.06 °	4.48 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
31	-0.51 °	5.08 °	8.85 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
32	1.51 °	-28.29 °	2.61 °	0.00 mm	0.32 mm	0.00 mm
33	0.00 °	0.00 °	2.13 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
34	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
35	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
36	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
37	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm
38	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 mm	0.00 mm	0.00 mm

Ti	TIP
R	Rotazione
To	Torque
B L	Buccale Linguale
E I	Estrusione Intrusione
M D	Mesiale Distale

Mascherina Trasparente 1 - 16

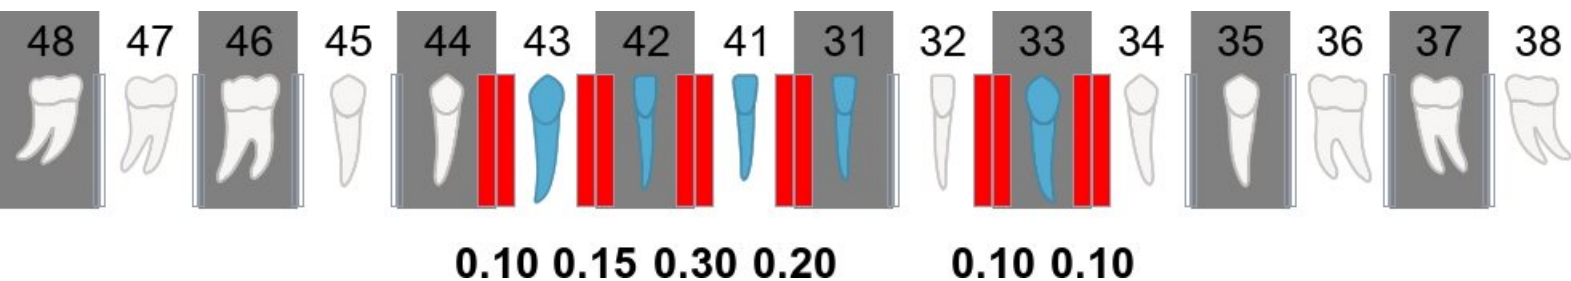

IPR	0.10 mm (44,43)
IPR	0.10 mm (32,33)
IPR	0.15 mm (43,42)
IPR	0.10 mm (33,34)
IPR	0.30 mm (42,41)
IPR	0.20 mm (41,31)

Effettuare l'operazione prima della mascherina 1









Panoramica del Setup: Arcata inferiore

Situazione Iniziale | Situazione Finale

#	Ti (Inizio)	Ti (Fine)	To (Inizio)	To (Fine)
48	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
47	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
46	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
45	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
44	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
43	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.18 °
42	0.00 °	2.66 °	0.00 °	7.31 °
41	0.00 °	1.01 °	0.00 °	4.48 °
31	0.00 °	-0.51 °	0.00 °	8.85 °
32	0.00 °	1.51 °	0.00 °	2.61 °
33	0.00 °	0.00 °	0.00 °	2.13 °
34	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
35	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
36	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
37	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °
38	0.00 °	0.00 °	0.00 °	0.00 °

Ti	TIP
To	Torque

Mascherina Trasparente 1 - 16




TIP	1.00 °
Rotazione	2.00 °
Torque	1.00 °
Buccale Linguale	0.25 mm
Estrusione Intrusione	0.10 mm
Mesiale Distale	0.25 mm
Distanza	0.11 mm
Numero di modelli desiderati	16
Template	SI
Ritarda stage per gli attachi	Nessun ritardo
Settimanale per allineatore	2 Settimanale
Tempo necessario	8 mesi

Durata del trattamento 8 mesi



Situazione Iniziale



Situazione Finale

